

Instrucciones de uso

C € EK IVD

IdentiClone® IGH Gene Clonality Assay

Para la identificación de reordenamientos genéticos de la cadena pesada de la inmunoglobulina.

Para uso diagnóstico in vitro





Condiciones de conservación: de -85°C a -65°C Los controles de ADN pueden separarse de los kits de prueba y conservarse a entre 2°C y 8°C.

Índice

1.	Uso	PREVISTO	3		
2.	RESUMEN Y EXPLICACIÓN DE LA PRUEBA				
	2.1.	Antecedentes	3		
	2.2.	Descripción general	3		
3.	Princ	CIPIOS DEL PROCEDIMIENTO	4		
	3.1.	Reacción en cadena de la polimerasa (PCR)	Δ		
	3.2.	Detección mediante fluorescencia diferencial			
4.	REAC	TIVOS	5		
••	4.1.	Componentes de los reactivos			
	4.1. 4.2.	Advertencias y precauciones			
	4.2. 4.3.	Advertencias y precauciones			
5.		RUMENTAL			
J.					
	5.1.	Termociclador			
	5.2.	Instrumentos de electroforesis capilar ABI			
6.	Reco	OGIDA Y PREPARACIÓN DE LAS MUESTRAS	8		
	6.1.	Precauciones			
	6.2.	Sustancias interferentes			
	6.3.	Requisitos y manipulación de las muestras			
	6.4.	Preparación de las muestras			
	6.5.	Conservación de las muestras			
7.	Proc	CEDIMIENTO DE LA PRUEBA			
	7.1.	Materiales suministrados			
	7.2.	Materiales necesarios no suministrados			
	7.3.	Preparación de los reactivos			
	7.4.	Amplificación			
	7.5.	Detección por fluorescencia ABI			
	7.6. 7.7.	Control de calidad			
8.		RPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS.			
ο.					
	8.1.	Análisis			
	8.2.	Interpretación de la muestra	14		
9.	LIMIT	TACIONES DEL PROCEDIMIENTO	14		
10.	VALO	DRES PREVISTOS	15		
	10.1.	Tamaño previsto de los productos amplificados			
	10.2.	Datos de la muestra	16		
11.	EFICA	acia diagnóstica	18		
12.	BIBLI	OGRAFÍA	18		
13.	SERV	ICIO TÉCNICO Y ATENCIÓN AL CLIENTE	18		
14.	Ѕſмв	OLOS	19		
15.	Aviso	O LEGAL	19		
	15.1.	Garantía y responsabilidad	19		
	15.2.	Patentes y marcas registradas			

1. Uso previsto

La *IGH* Gene Clonality Assay IdentiClone es un producto de diagnóstico *in vitro* diseñado para la detección mediante PCR de reordenamientos genéticos de la cadena pesada de la inmunoglobulina en pacientes con sospecha de trastornos linfoproliferativos. La *IGH* Gene Clonality Assay sirve específicamente para:

- Identificar la presencia de clonalidad en trastornos linfoproliferativos atípicos.
- Respaldar un diagnóstico diferencial de lesiones reactivas y neoplasias hemáticas⁴.
- Asignar el supuesto linaje de los trastornos linfoproliferativos monoclonales maduros.
- Identificar marcadores tumorales específicos (reordenamientos de IGH) para la vigilancia posterior al tratamiento.
- Controlar y evaluar las recidivas de la enfermedad.

2. Resumen y explicación de la prueba

2.1. Antecedentes

El reordenamiento de los genes de los receptores de antígenos se produce durante la ontogenia de los linfocitos B y T. Estos reordenamientos génicos generan productos únicos en materia de longitud y secuencia. Por eso, las pruebas por reacción en cadena de la polimerasa (PCR) sirven para identificar poblaciones de linfocitos derivadas de una única célula mediante la detección del reordenamiento de los genes V-J del locus del receptor de antígenos. En la prueba por PCR, se utilizan distintos cebadores de ADN que se dirigen a regiones genéticas conservadas del gen de la cadena pesada de la inmunoglobulina. Esta prueba, basada en ADN, sirve para detectar la gran mayoría de las neoplasias de los linfocitos B clonales. Los resultados de la prueba pueden analizarse con distintos métodos de detección, como la electroforesis en gel y capilar.

Las pruebas IdentiClone de Invivoscribe representan un nuevo enfoque para las pruebas de clonalidad mediante PCR. Estas pruebas se han optimizado minuciosamente mediante el análisis de muestras de control positivas y negativas con mezclas maestras múltiples. Tras el desarrollo de la prueba, se completó una importante fase de validación, que incluyó el análisis de más de 400 muestras clínicas de acuerdo con la clasificación Revised European/American Lymphoma (REAL). Este análisis se realizó en más de 30 conocidos centros de análisis de toda Europa, como parte de un estudio colaborativo denominado BIOMED-2 Concerted Action.²

Las pruebas de detección mediante ABI no detectan de forma fiable aquellas poblaciones clonales que representan menos del 1 % de la población de linfocitos total. Los resultados de las pruebas de clonalidad molecular siempre deben interpretarse en el contexto de los datos clínicos, histológicos e inmunofenotípicos disponibles.

2.2. Descripción general

Este kit de prueba incluye seis (6) mezclas maestras. Las mezclas maestras *IGH* Tube A, B y C (Tubo A, B y C de *IGH*) se dirigen a las regiones marco 1, 2 y 3 (respectivamente) de la región variable y a la región de unión del locus de la cadena pesada de la inmunoglobulina. Por su parte, las mezclas maestras *IGH* Tube D y E (Tubo D y E de *IGH*) se dirigen a las regiones de diversidad y unión. Finalmente, la mezcla maestra Specimen Control Size Ladder (Control de la muestra con marcador de tamaño) se dirige a distintos genes para generar una serie de amplicones de 96, 197, 297, 397 y 602 pares de bases (pb) y garantizar que la calidad y la cantidad de ADN sean suficientes para que el resultado sea válido. En todas las pruebas de clonalidad génica de Invivoscribe, se usa el mismo programa del termociclador y métodos de detección similares. Esto mejora la uniformidad y facilita la formación cruzada sobre numerosas pruebas distintas.

Esta prueba se basa en EuroClonality/BIOMED-2 Concerted Action BMH4-CT98-3936.




3. Principios del procedimiento

3.1. Reacción en cadena de la polimerasa (PCR)

Las pruebas por PCR suelen utilizarse para identificar poblaciones clonales de linfocitos B. Estas pruebas amplifican el ADN situado entre cebadores dirigidos al marco (FR) conservado de las regiones variables (V) y de unión (J) (IGH Tubes A, B y C [Tubos A, B y C de IGH]), así como de las regiones de diversidad (D) y de unión (IGH Tubes D y E [Tubos D y E de IGH]). Las regiones de preservación se encuentran a ambos lados de la región V-J en la que se producen los reordenamientos genéticos programados durante la maduración de los linfocitos B y T. Los genes del receptor de antígenos sujetos a reordenamiento son la cadena pesada de la inmunoglobulina, las cadenas ligeras de los linfocitos B y los genes del receptor de linfocitos T de los linfocitos T. Cada linfocito B y T presenta un solo reordenamiento V-J productivo que es único en longitud y en secuencia. Cuando el ADN de una población normal o policlonal se amplifica usando los cebadores de ADN que flanquean la región V-J, se genera una curva en forma de campana (distribución de Gauss) de amplicones que se ajustan al intervalo de tamaños previsto. Esta distribución de Gauss refleja la heterogeneidad de los reordenamientos en V-J (en ciertos casos, en ausencia de ADN de los linfocitos, no se ve el producto). El ADN de las muestras de población clonal da lugar a uno o dos productos amplificados prominentes (amplicones) en un fondo policlonal disminuido.



Tube B: 7 cebadores VH-FR2 + cebador JH de consenso Tube C: 7 cebadores VH-FR3 + cebador JH de consenso



Tube D: 6 cebadores DH + cebador JH de consenso Tube D: cebador DH7 + cebador JH de consenso

Figura 1. La imagen recoge la representación de la organización de un reordenamiento genético de la cadena pesada de la inmunoglobulina en el cromosoma 14. Las flechas negras representan las posiciones relativas de los cebadores que se dirigen al marco conservado (FR1-3) y las regiones de diversidad (D_H1-7), así como los segmentos de los genes J_H de consenso secuencia abajo. Los amplicones derivados de estas regiones se detectan con facilidad usando conjuntos de cebadores fluorescentes e instrumentos de electroforesis capilar para la detección por fluorescencia diferencial.

Dado que los genes del receptor de antígenos son polimórficos (están formados por una población heterogénea de secuencias de ADN relacionadas), es difícil emplear un solo conjunto de secuencias de cebadores de ADN para dirigirse a todas las regiones de preservación que flanquean el reordenamiento V-J. La diversidad de la región N y la mutación somática mezclan aún más las secuencias de ADN en estas regiones. Por lo tanto, son necesarias mezclas maestras múltiples, dirigidas a distintas regiones FR, para identificar la mayor parte de los reordenamientos clonales. Los reordenamientos clonales se identifican como productos prominentes de un solo tamaño en un fondo de amplicones de distintos tamaños que forman una distribución de Gauss en torno a un reordenamiento estadísticamente favorecido de tamaño medio. Obsérvese que los cebadores que amplifican las diferentes regiones FR, que se encuentran en tres secciones distintas del gen de la cadena pesada, generan un intervalo de tamaños diferente para los productos de V-J.

3.2. Detección mediante fluorescencia diferencial

La detección mediante fluorescencia diferencial suele utilizarse para resolver amplicones de distintos tamaños a través de un instrumento de electroforesis capilar. Los cebadores se conjugan con distintos colorantes fluorescentes (fluoróforos), de modo que puedan producir espectros de emisión tras su excitación con láser en el instrumento de electroforesis capilar. De este modo, cada colorante fluorescente se corresponde con una región de interés. Este sistema de detección da lugar a una gran sensibilidad, a la resolución de un solo nucleótido, a la detección diferencial

de los productos y a la cuantificación relativa. Por otro lado, prácticamente se elimina el uso de geles de agarosa y poliacrilamida, así como de productos cancerígenos, como el bromuro de etidio. Además, la detección diferencial da lugar a una interpretación precisa, reproducible y objetiva de los productos específicos del cebador y el archivado automático de los datos. La reproducibilidad interanalítica e intranalítica de determinación del tamaño mediante electroforesis capilar es de aproximadamente 1-2 nucleótidos. La reproducibilidad y la sensibilidad, unidas al archivado automático de los datos de las muestras, permiten la supervisión, el seguimiento y la comparación de los datos de pacientes individuales en el tiempo.

4. Reactivos

4.1. Componentes de los reactivos

Tabla 1. Kits disponibles

Número de catálogo	Descripción	Cant. por unidad
REF 91010061	IdentiClone IGH Gene Clonality Assay – ABI Fluorescence Detection	33 reacciones
REF 91010081	IdentiClone IGH Gene Clonality Assay MegaKit – ABI Fluorescence Detection	330 reacciones

Tabla 2. Componentes del kit

Reactivo	Número de catálogo	Componentes de los reactivos (principios activos)	Cant. por unidad	91010061 Número de unidades	91010081 Número de unidades	Temp. de conservación
	21010011CE	IGHTube A – 6FAM Distintos oligonucleótidos dirigidos a la región marco 1 del gen de la cadena pesada de la inmunoglobulina en una solución salina amortiguada.	1500 μL	1	10	
	21010101CE	IGHTube B – 6FAM Distintos oligonucleótidos dirigidos a la región marco 2 del gen de la cadena pesada de la inmunoglobulina en una solución salina amortiguada.	1500 μL	1	10	
Mezclas maestras	21010031CE	IGHTube C – HEX Distintos oligonucleótidos dirigidos a la región marco 3 del gen de la cadena pesada de la inmunoglobulina en una solución salina amortiguada.	1500 μL	1	10	-85°C
	21010041CE	IGHTube D – HEX Distintos oligonucleótidos dirigidos a las regiones de diversidad y de unión del gen de la cadena pesada de la inmunoglobulina en una solución salina amortiguada.	1500 μL	1	10	
	21010051CE	IGHTube E – 6FAM Distintos oligonucleótidos dirigidos a las regiones de diversidad y de unión del gen de la cadena pesada de la inmunoglobulina en una solución salina amortiguada.	1500 μL	1	10	
Mezcla maestra del control de amplificación	20960021	Specimen Control Size Ladder – 6FAM Distintos oligonucleótidos dirigidos a los genes de mantenimiento.	1500 μL	1	10	
	40881750	IVS-0030 Clonal Control DNA 200 µg/mL de ADN en TE 1/10	100 μL	1	5	
ADM de control de ""	40881090 positivo 40881390	IVS-0019 Clonal Control DNA 200 µg/mL de ADN en TE 1/10	100 μL	1	5	8°C
ADN de control positivo		IVS-0024 Clonal Control DNA 200 µg/mL de ADN en TE 1/10	100 μL	1	5	2°C-1
	40880430	IVS-0008 Clonal Control DNA 200 µg/mL de ADN en TE 1/10	100 μL	1	5 -85°C	-85°C
ADN de control negativo (normal)	40920010	IVS-0000 Polyclonal Control DNA 200 µg/mL de ADN en TE 1/10	100 μL	1	5	

Nota: La fabricación de estos kits no implica el uso de conservantes.

4.2. Advertencias y precauciones

- Este producto es para uso diagnóstico in vitro.
- Utilice este kit de análisis a modo de sistema. No utilice reactivos de otros fabricantes. Cualquier alteración del protocolo —como la realización de diluciones o reducciones de las reacciones de amplificación— puede afectar al rendimiento de la prueba e implicar la anulación de cualquier garantía derivada de la adquisición de estos kits.
- Los materiales son estables hasta la fecha de caducidad indicada cuando se almacenan y manipulan según las instrucciones. No utilice los kits después de la fecha de caducidad.
- El cumplimento del protocolo garantizará un rendimiento y una reproducibilidad óptimos. Asegúrese de usar el programa adecuado del termociclador, ya que, si usa otros programas, los resultados serán imprecisos o erróneos y darán lugar a falsos positivos y falsos negativos.
- No mezcle ni combine reactivos de kits con diferentes números de lote.
- Utilice equipos de protección personal estándar, siga las prácticas óptimas de laboratorio y tome las precauciones necesarias cuando trabaje con muestras. Manipule las muestras en instalaciones aprobadas de contención de seguridad biológica y ábralas solo en campanas de seguridad biológica certificadas. Use agua de calidad para procedimientos de biología molecular a la hora de preparar el ADN de la muestra.
- Dado que se trata de una prueba de sensibilidad analítica, debe ser extremadamente cauteloso para evitar la contaminación de los reactivos o mezclas de amplificación con muestras, material de referencia o material amplificado. Preste mucha atención a los reactivos para detectar posibles signos de contaminación (p. ej., controles negativos con señales positivas). Elimine cualquier reactivo que pueda haberse contaminado.
- Para reducir al mínimo la contaminación, use guantes limpios cuando manipule muestras y reactivos y limpie de manera regular las zonas de trabajo y las pipetas antes de realizar la PCR.
- La esterilización por autoclave no elimina la contaminación del ADN. En el laboratorio de PCR, siga una secuencia de trabajo unidireccional entre zonas de trabajo: zona de preparación de mezclas maestras, zona de preparación de muestras, zona de amplificación y zona de detección. No lleve ADN amplificado a las zonas designadas para la preparación de mezclas maestras y muestras.
- Las pipetas, puntas de pipetas y cualquier otro instrumento utilizado en una zona específica deben ser de uso exclusivo de dicha zona.
- Siempre que sea posible, utilice material plástico estéril desechable para evitar la contaminación con RNasa y DNasa o la contaminación cruzada.

4.3. Almacenamiento y manipulación

- Si no va a hacer un uso inmediato de los kits de prueba, consérvelos a una temperatura de entre -85°C y -65°C.
- La temperatura de conservación óptima para los controles de ADN es de entre 2°C y 8°C, pero los controles de ADN pueden conservarse a entre −85°C y −65°C.
- Tanto los reactivos como el material de referencia deben descongelarse y mezclarse en un agitador vorticial antes de usarse para garantizar la resuspensión. Una agitación vorticial excesiva puede dañar el ADN y hacer que los cebadores marcados pierdan sus fluoróforos.
- Los materiales son estables hasta la fecha de caducidad indicada cuando se almacenan y manipulan según las instrucciones. No utilice los kits después de la fecha de caducidad.
- Debido a las altas concentraciones de sal, las mezclas maestras para PCR son sensibles a los ciclos de congelación/descongelación. Vierta las mezclas maestras en tubos estériles con cierre roscado y junta tórica si es necesario.

5. Instrumental

5.1. Termociclador

- Uso o función: amplificación de muestras de ADN
- Instrumental recomendado: termociclador Veriti™ o equivalente
- Eficacia diagnóstica y especificación:
 - o Intervalo térmico mínimo: de 15°C a 96°C
 - Velocidad de aceleración mínima: 0,8°C/s
- Siga las instrucciones de instalación, uso, calibración y mantenimiento del fabricante.
- Consulte el apartado 7.4, Amplificación, para conocer el programa del termociclador.

5.2. Instrumentos de electroforesis capilar ABI

- Uso o función: detección y análisis de fragmentos
- Eficacia diagnóstica y especificación:
 - Los siguientes instrumentos de electroforesis capilar se ajustan a las necesidades diagnósticas de la prueba:
 - ABI 310 Genetic Analyzer (1-capillary) (Analizador genético [1 capilar])
 - ABI 3100 Avant Genetic Analyzer (4-capillaries) (Analizador genético [4 capilares])
 - ABI 3100 Genetic Analyzer (16 capilares) (Analizador genético [16 capilares])
 - ABI 3130 Genetic Analyzer (4-capillaries) (Analizador genético [4 capilares])
 - ABI 3130xL Genetic Analyzer (16-capillaries) (Analizador genético [16 capilares])
 - ABI 3500 Genetic Analyzer (8-capillaries) (Analizador genético [8 capilares])
 - ABI 3500xL Genetic Analyzer (24-capillaries) (Analizador genético [24 capilares])
- Siga las instrucciones de instalación, uso, calibración y mantenimiento del fabricante.
- El instrumento ABI debe calibrarse usando las soluciones patrón de la matriz que corresponda de acuerdo con el apartado 7.2, *Materiales necesarios no suministrados.*
- Utilice los ajustes predeterminados para el tipo de polímero y capilar.
- Consulte el apartado 7.5, Detección por fluorescencia ABI, para conocer las instrucciones de preparación de la muestra.

6. Recogida y preparación de las muestras

6.1. Precauciones

Las muestras biológicas procedentes de seres humanos pueden contener materiales posiblemente infecciosos. Manipule las muestras de acuerdo con la norma de la OSHA sobre patógenos de transmisión hemática y de acuerdo con un nivel de bioseguridad 2.

6.2. Sustancias interferentes

Las siguientes sustancias pueden interferir con la PCR:

- Quelantes de cationes divalentes
- Puntas de pipeta de baja retención
- EDTA (no significativo en concentraciones bajas)
- Heparina

6.3. Requisitos y manipulación de las muestras

Con este kit, puede analizarse ADN genómico con los siguientes orígenes:

- 5 cc de sangre periférica, biopsia de médula ósea o aspirado de médula ósea anticoagulado con heparina o EDTA (conservados a entre 2°C y 8°C y enviados a temperatura ambiente)
- 5 mm cúbicos como mínimo de tejido (conservados y enviados congelados o conservados y enviados en RPMI 1640 a temperatura ambiente o en hielo)
- 3 μg de ADN genómico (conservados a entre 2°C y 8°C y enviados a temperatura ambiente)
- Tejido o cortes fijados en formol e incluidos en parafina (conservados y enviados a temperatura ambiente)

6.4. Preparación de las muestras

Extraiga el ADN genómico de las muestras de los pacientes lo antes posible. Vuelva a suspender el ADN en concentraciones finales de entre 100 μ g y 400 μ g por mL en TE 1/10 (1 mM de Tris-HCl, pH 8,0 y 0,1 mM de EDTA) o en agua de calidad para biología molecular o que reúna las condiciones de la USP. Este es un sistema de pruebas sólido. Los resultados válidos derivan de un amplio abanico de concentraciones de ADN. Por lo tanto, cuantificar y ajustar las concentraciones de ADN no suele ser necesario. Analizar el ADN de la muestra con la mezcla maestra Specimen Control Size Ladder (Control de la muestra con marcador de tamaño) garantizará que la calidad y la cantidad del ADN sean suficientes para que el resultado sea válido.

6.5. Conservación de las muestras

Conserve el ADN genómico a entre 2°C y 8°C o a entre -85°C y -65°C hasta que vaya a usarlo.

7. Procedimiento de la prueba

7.1. Materiales suministrados

Tabla 3. Componentes del kit

Número de catálogo	Descripción
21010011CE	<i>IGH</i> Tube A – 6FAM
21010101CE	<i>IGH</i> Tube B – 6FAM
21010031CE	IGH Tube C – HEX
21010041CE	IGH Tube D – HEX
21010051CE	<i>IGH</i> Tube E – 6FAM
20960021	Specimen Control Size Ladder – 6FAM
40881750	IVS-0030 Clonal Control DNA
40881090	IVS-0019 Clonal Control DNA
40881390	IVS-0024 Clonal Control DNA
40880430	IVS-0008 Clonal Control DNA
40920010	IVS-0000 Polyclonal Control DNA

7.2. Materiales necesarios no suministrados

Tabla 4. Materiales necesarios no suministrados

Reactivo o material	Reactivo o material recomendado y proveedor	Número de catálogo	Notas
ADN polimerasa	Roche: • EagleTaq DNA Polymerase Invivoscribe, Inc.: • FalconTaq DNA Polymerase o equivalente	05206944190 60970130	N. P.
Agua de calidad USP o para biología molecular desionizada y destilada en vidrio	N. P.	N. P.	Estéril y exenta de DNasa y RNasa.
Pipetas calibradas	Rainin: ■ Pipetas P-2, P-20, P-200 y P-1000 ■ O pipetas SL-2, SL-20, SL-200 y SL-1000	N. P.	Deben ser capaces de medir con precisión volúmenes de entre 1 µL y 1000 µL.
Termociclador	Thermo Fisher Scientific: Veriti Dx Thermal Cycler Bio-Rad: MJ Research PTC-100 o PTC-200, PTC-220, PTC-240 Perkin-Elmer PE 9600 o PE 9700	N. P.	N. P.
Agitador vorticial	N. P.	N. P.	N. P.
Placas o tubos para PCR	N. P.	N. P.	Estériles
Puntas de pipeta con filtro	N. P.	N. P.	Estériles y exentas de RNasa, DNasa y pirógenos
Tubos para microcentrífuga	N. P.	N. P.	Estériles
Instrumento de electroforesis capilar ABI	Applied Biosystems: ◆ ABI 310, 3100 o 3500 series	N. P.	N. P.
Formamida Hi-Di	Applied Biosystems: ● Hi-Di TM Formamide	4311320	N. P.
Patrones de tamaño	Invivoscribe: • Hi-Di Formamide con patrones de tamaño ROX para ABI 3100 Applied Biosystems: • Para ABI 3100 o 3130 instruments: • GeneScan™ - 400HD [ROX]™ • Para ABI 3500 instruments: • GeneScan - 600 [LIZ]™ v2.0	60980061 402985 4408399	N. P.

Tabla 4. Materiales necesarios no suministrados

Reactivo o material	Reactivo o material recomendado y proveedor	Número de catálogo	Notas
Colorantes para calibración espectral	Applied Biosystems: Para ABI 3100 y 3130 instruments: DS-30 Matrix Standard Kit (Dye Set D) Para ABI 310 instruments: NED Matrix Standard Y Fluorescent Amidite Matrix Standards [6FAM, TET, HEX, TAMRA, ROX] Para ABI 3500 instruments: DS-33 Matrix Standard Kit (Dye Set G5)	4345827 402996 401546 4345833	N. P.
Polímero	Applied Biosystems: • POP-4™ Polymer: • POP-4 para 310 Genetic Analyzers • POP-4 para 3100/3100-Avant Genetic Analyzers • POP-4 para 3130/3130xL Genetic Analyzers • POP-7™ Polymer: • POP-7 para 3130/3130xL Genetic Analyzers • POP-7 para 3500/3500xL Genetic Analyzers	402838 4316355 4352755 4352759 4393714	N. P.
Solución amortiguadora	Applied Biosystems: • 10X Genetic Analyzer Buffer with EDTA	402824	Diluir 1:10 en agua estéril antes de usar

7.3. Preparación de los reactivos

- Las muestras desconocidas pueden analizarse usando la mezcla maestra Specimen Control Size Ladder para garantizar la ausencia de inhibidores de la amplificación y la presencia de la cantidad y la calidad necesarias del ADN para generar un resultado válido.
- Los resultados de las pruebas realizadas una sola vez son válidos. No obstante, analice por duplicado siempre que sea posible. Si los análisis por duplicado arrojan resultados incoherentes, será necesario realizar un nuevo análisis
- Analice los controles **positivos**, **negativos** y **sin molde** de cada mezcla maestra.
- Combine varias muestras en un mismo desarrollo para evitar quedarse sin el control negativo (IVS-0000 Polyclonal Control DNA). Si en el laboratorio no resulta práctico combinar muestras, puede comprar el IVS-0000 Polyclonal Control DNA por separado.
- 7.3.1. Póngase los guantes para sacar las mezclas maestras del congelador. Deje que los tubos se descongelen. A continuación, mezcle en el agitador vorticial.
- 7.3.2. Encienda la campana de extracción o la cabina para PCR y pipetee una parte de cada mezcla maestra a los tubos para microcentrífuga, que deberán estar esterilizados y limpios.
 - Volúmenes de las partes = $45 \mu L$ por reacción.
 - Añada una reacción adicional por cada 15 reacciones para corregir errores de pipeteo.
 - Para cada mezcla maestra (excepto para la Specimen Control Size Ladder), el número de reacciones (n) es:

$n = 2 \times núm$. de muestras	(analice las muestras por duplicado)
+1	ADN de control positivo (Consulte el apartado 7.7, Controles positivos recomendados)
+1	ADN de control negativo (IVS-0000 Polyclonal Control DNA)
+1	Control sin molde (agua)
+1	Para corregir errores de pipeteo

 $n = 2 \times núm$. de muestras + 4

- Por lo tanto, el volumen total de la parte para cada mezcla maestra = $n \times 45 \mu L$.
- Para la mezcla maestra Specimen Control Size Ladder, el número de reacciones (m) es:

m = núm do muoctros + 2	Total
+1	Para corregir errores de pipeteo
+1	Control sin molde (agua)
+1	ADN de control positivo (IVS-0000 Polyclonal Control DNA)
m = núm. de muestras	(analice las muestras por duplicado)

m = núm. de muestras + 3 Total

Por lo tanto, el volumen total de la parte de la mezcla maestra Specimen Control Size Ladder = m x 45 µL.

- 7.3.3. Añada 1,25 U (o 0,25 μ L a 5 U/ μ L) de ADN polimerasa Taq por reacción a cada mezcla maestra.
 - ADN polimerasa Taq total pipeteada a cada mezcla maestra = $\mathbf{n} \times 0.25 \, \mu \text{L}$; $\mathbf{m} \times 0.25 \, \mu \text{L}$ para la mezcla maestra Specimen Control Size Ladder.
 - Mezcle suavemente en el agitador vorticial.
- 7.3.4. Por cada reacción, vierta 45 μ L de la mezcla maestra que corresponda + la solución de ADN polimerasa en los pocillos de una placa o un tubo para PCR.
- 7.3.5. Añada 5 µL del molde que corresponda (ADN de muestra, ADN de control positivo, ADN de control negativo o agua) a los pocillos individuales que contengan las mezclas maestras.
 - Pipetee arriba y abajo varias veces para mezclar.
- 7.3.6. Tape o cubra la placa para PCR.
 - Las muestras estarán listas para su amplificación en un termociclador.
 - Si la amplificación no puede realizarse inmediatamente después de preparar el reactivo, las placas o tubos para PCR pueden conservarse a entre 2°C y 8°C durante 24 horas como máximo.

Guía rápida:

Por cada mezcla maestra y **n** de reacciones, mezcle:

 ${f n} \times 45 ~\mu L$ Mezcla maestra ${f n} \times 0,25 ~\mu L$ ADN polimerasa Taq Mezcle suavemente en el agitador vorticial.

Pipetee $45~\mu L$ de la mezcla maestra + la solución de ADN polimerasa en cada pocillo.

Añada 5 µL del molde que corresponda en cada pocillo.

Volumen total de la reacción = 50 μL

7.4. Amplificación

- 7.4.1. Amplifique las muestras siguiendo este programa para PCR:
 - Seleccione la opción de medición de la temperatura indicada en el termociclador BioRad MJ Research PTC.

Paso Temperatura 7 minutos 1 1 95°C 2 45 segundos 95°C 3 35 60°C 45 segundos 4 72°C 90 segundos 5 72°C 10 minutos 1 6 15°C ∞ 1

Tabla 5: Condiciones del termociclador

- 7.4.2. Extraiga la placa o los tubos de amplificación del termociclador.
 - Aunque el ADN amplificado sea estable a temperatura ambiente durante largos períodos, conserve los productos de PCR a entre 2°C y 8°C hasta la detección.
 - La detección debe realizarse en los 30 días posteriores a la amplificación.

7.5. Detección por fluorescencia ABI

- En la detección por fluorescencia ABI, suele observarse un pico precedente; se trata de un artefacto del método de detección que utiliza la plataforma ABI. Los picos precedentes suelen ser asimétricos; la base suele inclinarse en el lado derecho hacia el pico real. Esto es especialmente evidente en el caso de la mezcla maestra Specimen Control Size Ladder, con un pico de 84 nucleótidos precedente al pico real, de 96 nucleótidos.
- Evite la multiplicación de productos de PCR procedentes de diferentes mezclas maestras, pues esta dará lugar a una menor sensibilidad general.

Plataformas ABI 310, 3100 o 3130

- 7.5.1. Mezcle, en un tubo para microcentrífuga nuevo, la cantidad pertinente (para un total de 10 μL por reacción) de Hi-Di Formamide con ROX Size Standards. Mezcle bien en el agitador vorticial.
- 7.5.2. En una placa de 96 pocillos para PCR nueva, vierta 10 μL de la mezcla de Hi-Di Formamide y los ROX Size Standards en un pocillo por reacción.
- 7.5.3. Pipetee 1 μ L de cada reacción a los pocillos que contienen la mezcla de Hi-Di Formamide y los ROX Size Standards.
 - Pipetee una muestra por pocillo.
 - Pipetee arriba y abajo para mezclar.
- 7.5.4. Tape o cubra la placa o tubos para PCR.
- 7.5.5. Desnaturalice las muestras a 95°C durante 2 minutos; a continuación, enfríelas en hielo durante 5 minutos.
- 7.5.6. Prepare una hoja de muestras y una lista de inyección para las muestras.
- 7.5.7. Desarrolle las muestras en un equipo de electroforesis capilar ABI de acuerdo con el manual del usuario.
 - Los datos se muestran de forma automática como picos de tamaños y colores específicos.
- 7.5.8. Revise el perfil y los controles y notifique los resultados. Consulte los apartados 8, *Interpretación de los resultados*, y 10, *Valores previstos*.

Plataformas ABI 3500

- Nota: Habida cuenta de las variaciones entre instrumentos por lo que respecta al rendimiento de la plataforma ABI 3500, las cantidades de formamida, muestra y patrón de tamaño que se recogen en el protocolo son puramente indicativas. Es posible que se deba optimizar el protocolo para las plataformas ABI 3500.
 - 7.5.9. Mezcle, en un tubo para microcentrífuga nuevo, la cantidad pertinente (9,5 µL por reacción) de Hi-Di Formamide con los LIZ Size Standards. Mezcle bien en el agitador vorticial.
 - 7.5.10. En una placa de 96 pocillos para PCR nueva, vierta 9,5 μ L de la mezcla de Hi-Di Formamide y los LIZ Size Standards en un pocillo por reacción.
 - 7.5.11. Pipetee 0,5 µL de cada reacción en los pocillos que contienen la mezcla de Hi-Di Formamide y los LIZ Size Standards.
 - Pipetee una muestra por pocillo.
 - Pipetee arriba y abajo para mezclar.
 - 7.5.12. Tape o cubra la placa para PCR.
 - 7.5.13. Desnaturalice las muestras a 95°C durante 3 minutos; a continuación, enfríelas en hielo durante 5 minutos.
 - 7.5.14. Prepare una hoja de muestras y una lista de inyección para las muestras.
 - 7.5.15. Desarrolle las muestras en un equipo de electroforesis capilar ABI 3500 de acuerdo con el manual del usuario.
 - Los datos se muestran de forma automática como picos de tamaños y colores específicos.
 - 7.5.16. Revise el perfil y los controles y notifique los resultados. Consulte los apartados 8, *Interpretación de los resultados*, y 10, *Valores previstos*..

7.6. Control de calidad

Con el kit se suministran controles positivos y negativos (o normales); estos pueden desarrollarse una sola vez cada vez que se realiza la prueba, a fin de garantizar una realización adecuada. También debe desarrollarse un control sin molde (p. ej., agua) para saber si la mezcla maestra se ha contaminado y si existe contaminación cruzada en las reacciones de la PCR por el uso de técnicas inadecuadas. Por otro lado, debe incluirse un control de la solución amortiguadora para garantizar que la solución amortiguadora no esté contaminada. Los valores de los controles positivos figuran en el apartado 10.1, Tamaño previsto de los productos amplificados. Invivoscribe ofrece controles adicionales y controles de sensibilidad (diluciones de controles positivos en el control negativo).

7.7. Controles positivos recomendados

Los tamaños indicados para el amplicón se determinaron utilizando una plataforma ABI. Los tamaños del amplicón observados con el instrumento de electroforesis capilar pueden diferir en 1-4 nucleótidos (nt) de los indicados, en función de la plataforma de detección y de la versión del software de análisis utilizado. Una vez identificado, el tamaño del amplicón determinado en la plataforma específica será coherente entre desarrollos. La reproducibilidad es extremadamente útil para el control de las recidivas.

Nota: Con "color", se hace referencia al color de los productos generados con la mezcla maestra cuando se utiliza la asignación de color por defecto en los sistemas de detección por fluorescencia ABI.

Tabla 6. Controles positivos recomendados

Mezcla maestra	Diana	Color	ADN de control	Número de catálogo	Tamaño del producto (nt)
<i>IGH</i> Tube A	FR1-J _H	Azul	Intervalo de tamaños válido IVS-0030 Clonal Control DNA	 40881750	310-360 280°, 325
<i>IGH</i> Tube B	FR2-J _H	Azul	Intervalo de tamaños válido IVS-0030 Clonal Control DNA	 40881750	250-295 260
<i>IGH</i> Tube C	FR3-J _H	Verde	Intervalo de tamaños válido IVS-0019 Clonal Control DNA	 40881090	100-170 145
<i>IGH</i> Tube D	D _H -J _H	Verde	Intervalo de tamaños válido IVS-0024 Clonal Control DNA	 40881390	110-290, 390-420 139
<i>IGH</i> Tube E	D _H 7-J _H	Azul	Intervalo de tamaños válido IVS-0008 Clonal Control DNA	 40880430	100-130 ^b 109
Specimen Control Size Ladder	Distintos genes	Azul	Intervalo de tamaños válido IVS-0000 Polyclonal Control DNA	40920010	96, 197, 297, 397, 602 ° 96, 197, 297, 397, 602°

^aNota: ^bNota: Podrían observarse picos de 280 nt, a pesar de que el tamaño del amplicón no se ajuste al intervalo de tamaños válido para *IGH* Tube A. Los productos de la PCR de 209 nt representan el pico de menor tamaño de la región D_H7-J_H1 de la estirpe germinal. Si la amplificación por PCR resulta muy eficaz, podrían obtenerse también productos de mayor tamaño por la hibridación del cebador en los reordenamientos génicos J_H secuencia abajo; p. ej., 416 nt (D_H7-J_H2), 1028 nt (D_H7-J_H3), etc.

cNota:

Dado que los fragmentos de PCR más pequeños se amplifican de manera preferente, no es extraño que el fragmento de 602 nt presente una menor señal o esté completamente ausente. En la detección por fluorescencia ABI, los picos de 602 nt podrían no aparecer en un desarrollo normal. Además, el tamaño del pico puede diferir en más de 30 nt cuando el tamaño del fragmento se extrapola usando los patrones de tamaño GeneScan - 400HD [ROX].

8. Interpretación de los resultados

A pesar de que un resultado positivo podría ser indicativo de neoplasia maligna, interprete los resultados tanto positivos como negativos teniendo en cuenta los datos clínicos y los resultados de los análisis. Se determinó el intervalo de tamaños para las mezclas maestras mediante el análisis de las muestras de control positivo y negativo. Para que la interpretación sea precisa y significativa, deben descartarse los picos que no se ajustan al intervalo de tamaños válido para cada una de las mezclas maestras.

8.1. Análisis

- 8.1.1. Indique lo siguiente para las muestras que no consiga amplificar tras repetir el análisis: "Se desconoce la naturaleza de la muestra porque la cantidad o la calidad del ADN eran insuficientes para su análisis".
- 8.1.2. Repita el análisis de las muestras que den negativo si falló la reacción del control positivo.
- 8.1.3. Si las muestras desarrolladas por duplicado arrojan resultados incompatibles, realice un nuevo análisis o una nueva evaluación de las muestras.
- 8.1.4. Deben examinarse todos los controles antes de interpretar los resultados de las muestras. Si los controles no arrojan resultados correctos, la prueba no es válida, por lo que no pueden interpretarse las muestras.

Tabla 7. A continuación, se describe el análisis de cada uno de los controles, así como las decisiones que deben tomarse en función de los resultados.

Tipo de control	Resultado previsto	Resultado anómalo
Control sin molde	Ausencia de amplificación: continúe con el análisis	Presencia de amplificación: repita la prueba.
Control policional	El tamaño de producto es coherente con el tamaño previsto en el apartado 10.1, Tamaño previsto de los productos amplificados. Ausencia de reordenamientos clonales. Continúe con el análisis.	Presencia de reordenamientos clonales. Repita la prueba.
Control positivo (puede usarse un control de extracción si el material de referencia positivo abarca procesos de extracción)	El tamaño de producto es coherente con el tamaño previsto en el apartado 10.1, Tamaño previsto de los productos amplificados. Continúe con el análisis.	Repita la prueba.
Specimen Control Size Ladder (este control de la amplificación es <u>fundamental</u> para muestras de cantidad y calidad desconocidas)	Si se observan picos de 96, 197, 297, 397 y 602 nt, continúe con el análisis. Dado que los fragmentos de PCR más pequeños se amplifican de manera preferente, no es extraño que el fragmento de 602 nt presente una menor señal o esté completamente ausente. Continúe con el análisis.	Si no se observan bandas, repita la prueba, <u>a</u> menos que la muestra arroje un resultado <u>positivo</u> . Si solo se observan 1, 2 o 3 bandas, vuelva a evaluar la muestra para comprobar la presencia de degradación del ADN, <u>a menos</u> <u>que la muestra arroje un resultado positivo</u> .

8.2. Interpretación de la muestra

Si los controles arrojan los resultados previstos, interprete las muestras clínicas del siguiente modo:

- Si se observan uno o dos picos positivos prominentes^a que se ajustan al intervalo de tamaño válido, debe notificarse lo siguiente:
 - "Positivo para la detección de reordenamientos genéticos de la cadena pesada de la inmunoglobulina coherentes con la presencia de una población de células clonales. De acuerdo con los criterios diagnósticos generales, las poblaciones de células clonales pueden ser indicativas de neoplasias hemáticas".
- Si no se observan picos positivos a que se ajusten al intervalo de tamaño válido, debe notificarse lo siguiente:
 - "Negativo para la detección de reordenamientos genéticos de la cadena pesada de la inmunoglobulina".

^aNota: Los criterios para definir un pico positivo son los siguientes:

- Son picos positivos aquellos derivados de productos generados a partir de muestras diagnósticas que se ajustan al
 intervalo de tamaño válido y presentan un tamaño al menos tres veces superior al tercer pico de mayor tamaño
 del fondo policional.
- Son picos positivos aquellos derivados de productos generados a partir de muestras recogidas tras el diagnóstico inicial que se ajustan al intervalo de tamaño válido y
 - 1) presentan un tamaño al menos tres veces superior al tercer pico de mayor tamaño, O
 - 2) son mayores que los picos adyacentes e idénticos en tamaño a los productos de los amplicones clonales generados con las muestras del mismo paciente y la misma mezcla maestra.

9. Limitaciones del procedimiento

- Este kit de prueba no identifica el 100 % de las poblaciones de células clonales.
- La prueba no es capaz de detectar de manera fiable menos de una célula positiva por cada 100 células normales.
- Los resultados de las pruebas de clonalidad molecular siempre deben interpretarse en el contexto de los datos clínicos, histológicos e inmunofenotípicos disponibles.
- Las pruebas de tipo PCR están sujetas a interferencia por degradación del ADN o inhibición de la PCR por EDTA, heparina y
 otros compuestos.

10. Valores previstos

10.1. Tamaño previsto de los productos amplificados

Los tamaños indicados para el amplicón se determinaron utilizando una plataforma ABI. Los tamaños del amplicón observados con el instrumento de electroforesis capilar pueden diferir en 1-4 nucleótidos (nt) de los indicados, en función de la plataforma de detección y de la versión del software de análisis utilizado. Una vez identificado, el tamaño del amplicón determinado en la plataforma específica será coherente entre desarrollos. La reproducibilidad es extremadamente útil para el control de las recidivas.

Nota: Con "color", se hace referencia al color de los productos generados con la mezcla maestra cuando se utiliza la asignación de color por defecto en los sistemas de detección por fluorescencia ABI.

Tabla 8. Tamaños previstos de los productos amplificados

Mezcla maestra	Diana	Color	ADN de control	Número de catálogo	Tamaño de producto (nt)
<i>IGH</i> Tube A	FR1-J _H	Azul	Intervalo de tamaño válido IVS-0000 Polyclonal Control DNA IVS-0030 Clonal Control DNA IVS-0019 Clonal Control DNA IVS-0024 Clonal Control DNA	40920010 40881750 40881090 40881390	310-360 310-360 280 ^a , 325 345 342
<i>IGH</i> Tube B	FR2-J _H	Azul	Intervalo de tamaño válido IVS-0000 Polyclonal Control DNA IVS-0030 Clonal Control DNA IVS-0019 Clonal Control DNA IVS-0024 Clonal Control DNA	40920010 40881750 40881090 40881390	250-295 250-295 260 285 277
<i>IGH</i> Tube C	FR3-J _H	Verde	Intervalo de tamaño válido IVS-0000 Polyclonal Control DNA IVS-0019 Clonal Control DNA	40920010 40881090	100-170 100-170 145
<i>IGH</i> Tube D	D _H -J _H	Verde	Intervalo de tamaño válido IVS-0000 Polyclonal Control DNA IVS-0030 Clonal Control DNA IVS-0019 Clonal Control DNA IVS-0024 Clonal Control DNA IVS-0008 Clonal Control DNA	40920010 40881750 40881090 40881390 40880430	110-290, 390-420 235-258, 344 ^b ^c ^c 139
<i>IGH</i> Tube E	D _H 7-J _H	Azul	Intervalo de tamaño válido IVS-0000 Polyclonal Control DNA IVS-0030 Clonal Control DNA IVS-0019 Clonal Control DNA IVS-0024 Clonal Control DNA IVS-0008 Clonal Control DNA	40920010 40881750 40881090 40881390 40880430	100-130 209 ^d , 416 ^d ^e ^e 109
Specimen Control Size Ladder	Distintos genes	Azul	Intervalo de tamaño válido IVS-0000 Polyclonal Control DNA	40920010	96, 197, 297, 397, 602 ^f 96, 197, 297, 397, 602 ^f

Podrían observarse picos de 280 nt, a pesar de que el tamaño del amplicón no se ajuste al intervalo de tamaños válido para IGH Tube A. aNota: bNota: Se observan picos inespecíficos de 344 nt como consecuencia de la hibridación transversal del cebador D_H2 a una secuencia de la región posterior a J_H4. A la hora de analizar fragmentos, este pico no migra con los productos de D-J. cNota: Se observan picos inespecíficos de 74, 94, 158, 176, 187, 200 y 344 nt en muchas estirpes celulares. En presencia de fondos policionales no se observan estas bandas. bNota: Los productos de la PCR de 209 nt representan el pico de menor tamaño de la región D_H7-J_H1 de la estirpe germinal. Si la amplificación por PCR resulta muy eficaz, podrían obtenerse también productos de mayor tamaño por la hibridación del cebador en los reordenamientos génicos J_H secuencia abajo; p. ej., 416 nt (D_H7-J_H2), 1028 nt (D_H7-J_H3), etc. eNota: Se observan picos inespecíficos de 79 y 123 nt en muchas estirpes celulares. En presencia de fondos policionales no se observan estas bandas. fNota: Dado que los fragmentos de PCR más pequeños se amplifican de manera preferente, no es extraño que el fragmento de 602 nt presente una menor señal o esté completamente ausente. En la detección por fluorescencia ABI, los picos de 602 nt podrían no aparecer en un desarrollo normal. Además, el tamaño del pico puede diferir en más de 30 nt cuando el tamaño del fragmento se extrapola usando los GeneScan - 400HD [ROX] Size Standards.

10.2. Datos de la muestra

Los datos que se muestran a continuación se generaron utilizando las mezclas maestras indicadas. Los productos amplificados se desarrollaron en un instrumento ABI.

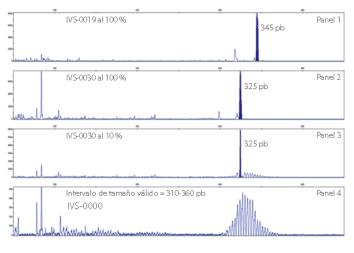


Figura 2. IGH Tube A

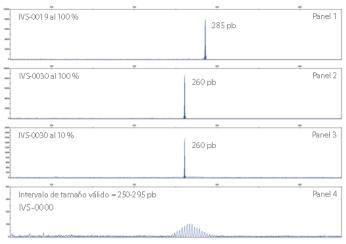


Figura 3. *IGH* Tube B

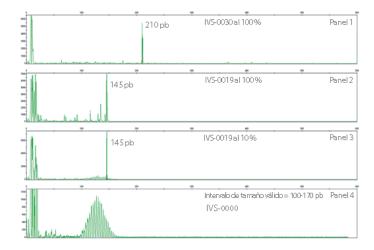


Figura 4. IGH Tube C

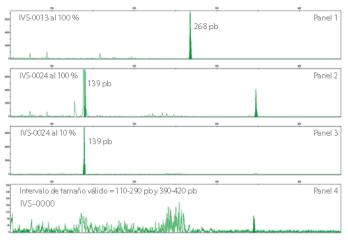


Figura 5. IGH Tube D

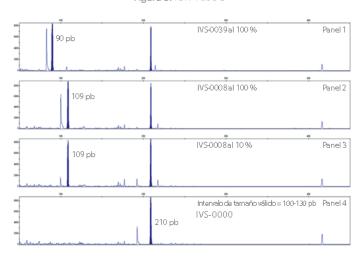


Figura 6. IGH Tube E

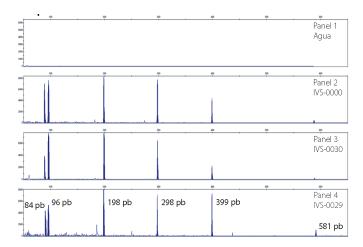


Figura 7. Mezcla maestra Specimen Control Size Ladder

11. Eficacia diagnóstica

La *IGH* Gene Clonality IdentiClone es una prueba por PCR rápida y fiable, mucho más sensible que la técnica de Southern (SB) para la detección de clonalidad en casos de sospecha de trastornos linfoproliferativos. El diagnóstico clínico e histopatológico final se correlaciona bien con los resultados de la PCR en un gran número de pacientes frente a los resultados de la técnica de SB, como indican dos artículos destacados que se mencionan más adelante.^{2,3}

Tabla 9. Estudios de concordancia

	Concordancia PCR-SB: ²	Concordancia PCR-SB:3
IGH:	sensibilidad del 93 % y especificidad del 92 %	IGH + IGK: sensibilidad del 85 %
IGK:	sensibilidad del 90 % y especificidad del 90 %	IGH + IGK: Sensibilidad del 85 %
IGL:	sensibilidad del 86 % y especificidad del 92 %	
TCRB:	sensibilidad del 86 % y especificidad del 98 %	TCRB: sensibilidad del 85 %
TCRG:	sensibilidad del 89 % y especificidad del 94 %	
TCRD:	sensibilidad del 83 % y especificidad del 95 %	

Tabla 10. Análisis mediante PCR frente a SB en relación con el estudio histopatológico y el diagnóstico final

	Concordancia PCR-SB:	Sensibilidad de la PCR:	Sensibilidad de la SB:
IGH + IGK:	85 %	98 %	39 %
TCRB:	85 %	96 %	35 %

El estudio de Sandberg *et al.* fue un estudio independiente de 300 muestras de distintos tipos.³ En los casos en los que se realizaron análisis tanto por PCR como por SB, cuyos resultados pudieron correlacionarse con los estudios histopatológicos y el diagnóstico final, se determinó que la eficacia diagnóstica de las pruebas IdentiClone fue de al menos un 96 %. Estas son, por consiguiente, mucho más precisas que las pruebas basadas en SB, que en este estudio pasaron por alto 23 casos evidentes de neoplasias y 7 casos de posibles neoplasias. Las pruebas IdentiClone no generaron resultados falsos positivos y tuvieron un nivel de precisión elevado.³ Un beneficio evidente de esta prueba fue que los resultados permitieron la detección posterior de reordenamientos genéticos específicos en los pacientes y en los tumores por lo que respecta a la detección de enfermedad mínima residual.

12. Bibliografía

- 1. Miller, J. E.; Wilson, S.S.; Jaye, D.J.; Kronenberg, M. (1999): An automated semiquantitative B and T cell clonality assay. *Molecular Diagnostics* 4, 101-117.
- 2. Van Dongen, J. J. M. *et al.* (2003): Design and standardization of PCR primers and protocols for detection of clonal immunoglobulin and T-cell receptor gene recombinations in suspect lymphoproliferations: Report of the BIOMED-2 Concerted Action BMH4-CT98-3936. *Leukemia*. 17, 2257-2317.
- 3. Sandberg, Y. *et al.* (2005): BIOMED-2 multiplex immunoglobulin/T-cell receptor polymerase chain reaction protocols can reliably replace Southern Blot analysis in routine clonality diagnostics. *J. Molecular Diagnostic* 7, 495-503.
- 4. van Krieken, J. H. J. M. *et al.* (2007): Improved reliability of lymphoma diagnostics via PCR-based clonality testing: Report of the BIOMED-2 Concerted Action BHM4-CT98-3936. *Leukemia* 21, 201-206.

13. Servicio técnico y atención al cliente

Los representantes del servicio técnico y de atención al cliente están disponibles de lunes a viernes para responder a sus preguntas por teléfono, correo electrónico o web.

Datos de Contacto

Invivoscribe, Inc

10222 Barnes Canyon Road | Building 1 | San Diego | California 92121-2711 | Estados Unidos Téléfono: +1 858 224-6600 | Fax: +1 858 224-6601 | Horario comercial: De 07:00 a 17:00 PST/PDT

Servicio técnico: support@invivoscribe.com | Atención al cliente: sales@invivoscribe.com | Sitio web: www.invivoscribe.com

14. Símbolos

Los siguientes símbolos figuran en el etiquetado de los productos de diagnóstico de Invivoscribe.



15. Aviso legal

15.1. Garantía y responsabilidad

Invivoscribe® Inc. (Invivoscribe®) se compromete a suministrar productos de primera calidad. Invivoscribe® garantiza que sus productos cumplen e incluso superan los criterios de rendimiento descritos en las Instrucciones de uso por lo que respecta a los productos cubiertos. Si alguno de los productos no funciona de acuerdo con las especificaciones indicadas para el producto en cuestión, nuestra política es reemplazar el producto o abonar el precio total de compra. Invivoscribe® no ofrece ninguna otra garantía, explícita o implícita. La responsabilidad de Invivoscribe® se limita al precio de compra del producto. Invivoscribe® no se responsabilizará de daños directos, indirectos, consecuentes o accidentales derivados del uso, los resultados del uso o la imposibilidad de usar sus productos. Debe establecerse y controlarse continuamente la eficacia del producto en condiciones controladas por el comprador y en su laboratorio a través de procesos definidos y controlados por el comprador, entre los que se incluyen las pruebas con controles positivos, negativos y sin molde cada vez que se analiza una muestra. El pedido, la aceptación y el uso del producto constituyen la aceptación por parte del comprador de la responsabilidad exclusiva de garantizar la eficacia del producto y el acuerdo del comprador con la limitación de la responsabilidad.

Este es un producto de diagnóstico in vitro que no está disponible para su venta o uso en Norteamérica.

15.2. Patentes y marcas registradas

Este producto está cubierto por una o más de las siguientes: patente europea número 1549764, patente europea número 2418287, patente europea número 2460889, patente japonesa número 4708029, patente de estadounidense número 8859748. Solicitudes pendientes y futuras relacionadas. Todas estas patentes y solicitudes se limitan únicamente a Invivoscribe®. También son aplicables patentes adicionales cuyo uso se ha autorizado a Invivoscribe. Muchos de estos productos implican el uso de métodos de amplificación de ácidos nucleicos, como la reacción en cadena de la polimerasa (PCR). Mediante la compra de este producto no se transmite de manera explícita ni implícita ninguna de las licencias de uso de estas patentes sobre enzimas o procesos de amplificación.

IdentiClone® es una marca comercial registrada de Invivoscribe®.

©2023 Invivoscribe, Inc. Todos los derechos reservados. Las marcas comerciales que figuran en este documento son propiedad de Invivoscribe, Inc., de sus filiales o, en el caso de las marcas comerciales de terceros, de sus respectivos dueños.